

《徵求領用公告》

※徵求領用一氧化碳分析儀、氯化氫分析儀、不透光率分析儀、氧氣一氧化氮分析儀、取樣調理儀器設備、廢氣處理連續監測系統等設備一批。均已逾使用年限(使用年限 5 年)且失原有效能。

※公告期日：106 年 9 月 29 日至 106 年 10 月 29 日止。

※有需求單位請於 106/10/30(星期一)前，電洽物理組李灝銘(分機 7502)，若無人領用，將逕行辦理報廢。


一、一氧化碳分析儀



取得日期	財產編號及名稱	型式/廠牌 (或土地建物標示)	數量	單價	保管單位	保管人	減損原因	使用 年限	已使用 年 月	
			單位	總價(原值/ 淨值)					年	月
092/10/29	3 -10 -08 -02 -0032 89-0000003 一氧化碳分析儀	model 48C 睿普工程	1.00		物理組	李灝銘	本財產已失原有效能,並 逾使用年限,報廢後變賣	5	13	10

※財產狀況說明：已逾使用年限，儀器訊號異常，失去原有功能。

二、氯化氫分析儀

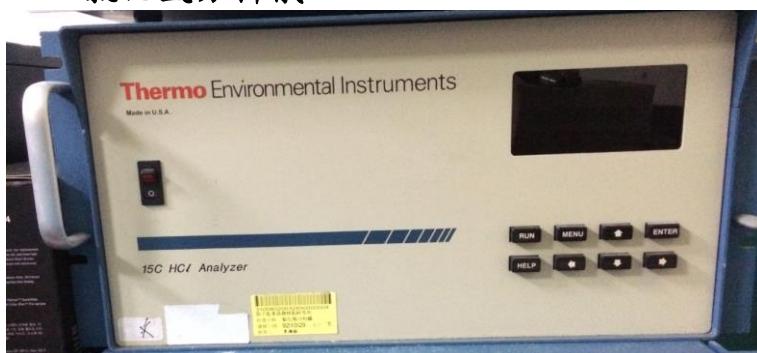

取得日期	財產編號及名稱	型式/廠牌 (或土地建物標示)	數量	單價	保管單位	保管人	減損原因	使用 年限	已使用 年 月	
			單位	總價(原值/ 淨值)					年	月
092/10/29	3 -10 -08 -02 -0032 89-0000004 氯化氫分析儀	model 15C 睿普工程	1.00		物理組	李灝銘	本財產已失原有效能,並 逾使用年限,報廢後變賣	5	13	10

※財產狀況說明：已逾使用年限，儀器無讀值，失去分析功能。


C. 不透光率分析儀



取得日期	財產編號及名稱	型式/廠牌 (或土地建物標示)	數量	單價	保管單位	保管人	減損原因	使用年限	已使用
			單位	總價(原值/ 淨值)					年 月
092/10/29	3-10-08-02-0032 89-0000005 不透光率分析儀	model 440 睿普工程	1.00		物理組	李灝銘	本財產已失原有效能,並 逾使用年限,報廢後變賣	5	13 10

※財產狀況說明：已逾使用年限，儀器訊號異常，失去原有分析功能。

D. 氧氣一氧化氮分析儀

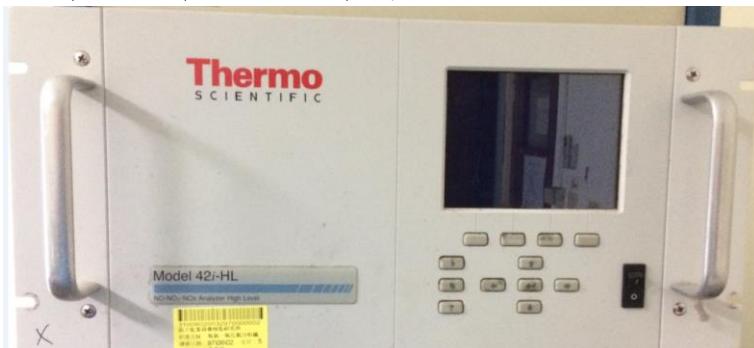

取得日期	財產編號及名稱	型式/廠牌 (或土地建物標示)	數量	單價	保管單位	保管人	減損原因	使用年限	已使用
			單位	總價(原值/ 淨值)					年 月
097/06/02	3-10-08-02-0032 97-0000002 氯氣一氧化氮分析儀		1.00		物理組	李灝銘	本財產已失原有效能,並 逾使用年限,報廢後變賣	5	9 2

※財產狀況說明：已逾使用年限，儀器訊號異常，失去原有分析功能。

E. 取樣調理儀器設備



取得日期	財產編號及名稱	型式/廠牌 (或土地建物標示)	數量	單價	保管單位	保管人	減損原因	使用年限	已使用	
			單位	總價(原值/ 淨值)					年	月
097/08/07	3 -10 -11 -01 -0011 97-0000004 取樣調理儀器設備	睿普工程	1.00		物理組	李灝銘	本財產已失原有效能,並 逾使用年限,報廢後變賣	5	9	0

※財產狀況說明：已逾使用年限，設備老舊失去原有功能。

F. 廢氣處理連續監測系統



取得日期	財產編號及名稱	型式/廠牌 (或土地建物標示)	數量	單價	保管單位	保管人	減損原因	使用年限	已使用	
			單位	總價(原值/ 淨值)					年	月
093/05/14	3 -10 -11 -03 -0204 93-0000001 廢氣處理連續監測系統	睿普工程	1.00		物理組	李灝銘	本財產已失原有效能,並 逾使用年限,報廢後變賣	5	13	3

※財產狀況說明：已逾使用年限，控制電腦無法開機，儀器訊號異常損壞無法正常使用。